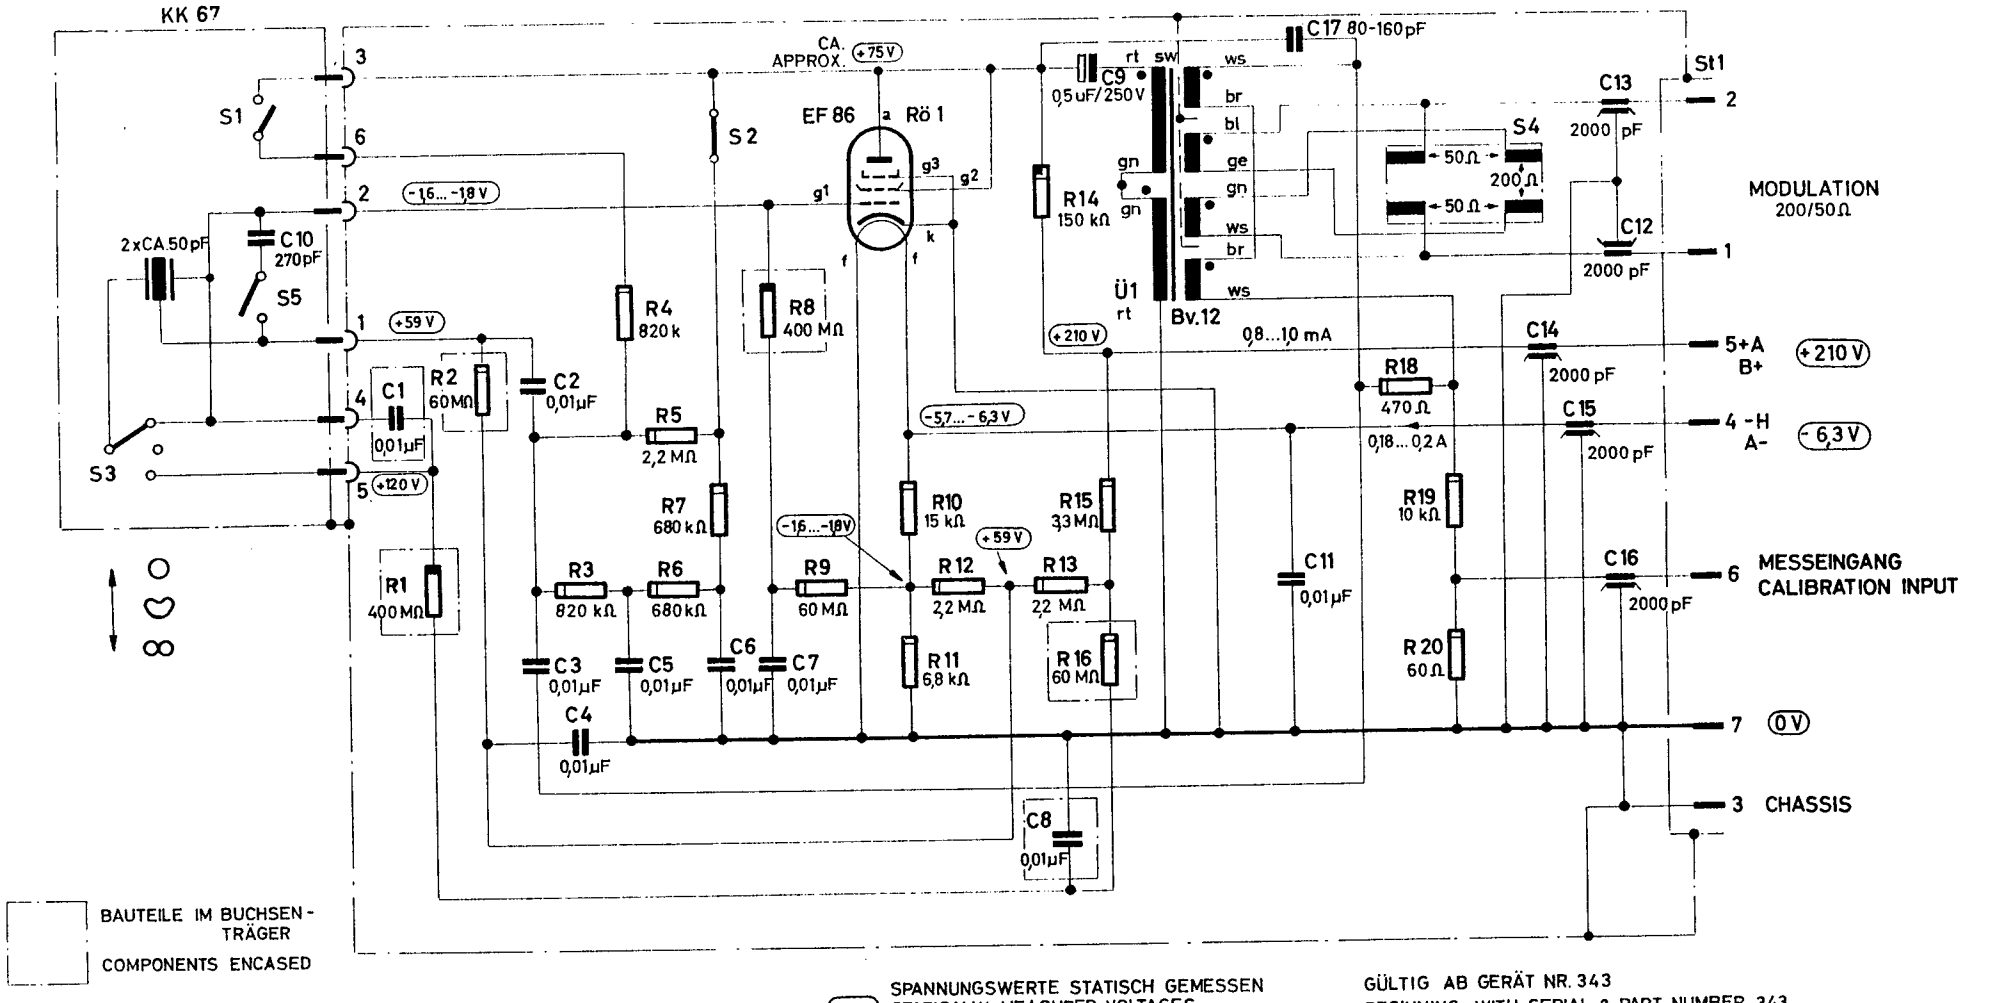
KK 67
S1
S2
S3
S4
S5
2xCA.50pF
C10 270pF
C1 0,01µF
R2 60MΩ
R1 400MΩ
C2 0,01µF
R4 820k
R5 2,2 MΩ
R7 680 kΩ
R3 820 kΩ
R6 680kΩ
C3 0,01µF
C5 0,01µF
C6 0,01µF
C7 0,01µF
C4 0,01µF
R8 400 MΩ
R9 60 MΩ
CA. APPROX. +75V
EF 86
Rö 1
R10 15 kΩ
R11 6,8 kΩ
R12 2,2 MΩ
R13 2,2 MΩ
R15 3,3 MΩ
R16 60 MΩ
C8 0,01µF
C9 0,5uF/250V
R14 150 kΩ
Ü1
Bv.12
0,8...1,0 mA
C17 80-160pF
C11 0,01µF
R18 470Ω
0,18...0,2A
R19 10 kΩ
R20 60Ω
C13 2000 pF
C12 2000 pF
C14 2000 pF
C15 2000 pF
C16 2000 pF
50Ω
200Ω
50Ω
St1
MODULATION 200/50Ω
5+A B+ +210V
4 -H A- -6,3V
6 MESSEINGANG CALIBRATION INPUT
7 0V
3 CHASSIS
-1,6...-1,8V
+59V
+120V
+210V
-5,7...-6,3V
BAUTEILE IM BUCHSEN-TRÄGER
COMPONENTS ENCASED
SPANNUNGSWERTE STATISCH GEMESSEN
STATICALLY MEASURED VOLTAGES
GÜLTIG AB GERÄT NR. 343
BEGINNING WITH SERIAL & PART NUMBER 343
Rö 1
EF 86
St 1
NT 3470-10 (SPEC.)
AUF DIE STECKER GESEHEN
PIN VIEW
0,1 W DIN 41399
0,25 W DIN 41401
0,5 W DIN 41402
RESISTORS
GERMAN AMERICAN
KONDENSATOR-MIKROPHON U 67
CONDENSER MICROPHONE U 67
U 67-930-01
GEORG NEUMANN
Laboratorium für Elektroakustik GmbH.
BERLIN
BEI ERSATZTEILBESTELLUNG GERÄT NR. UND POS.-ZAHLEN ANGEBEN
FOR REPLACEMENT ALWAYS GIVE SERIAL & PART NUMBER
22.12.64